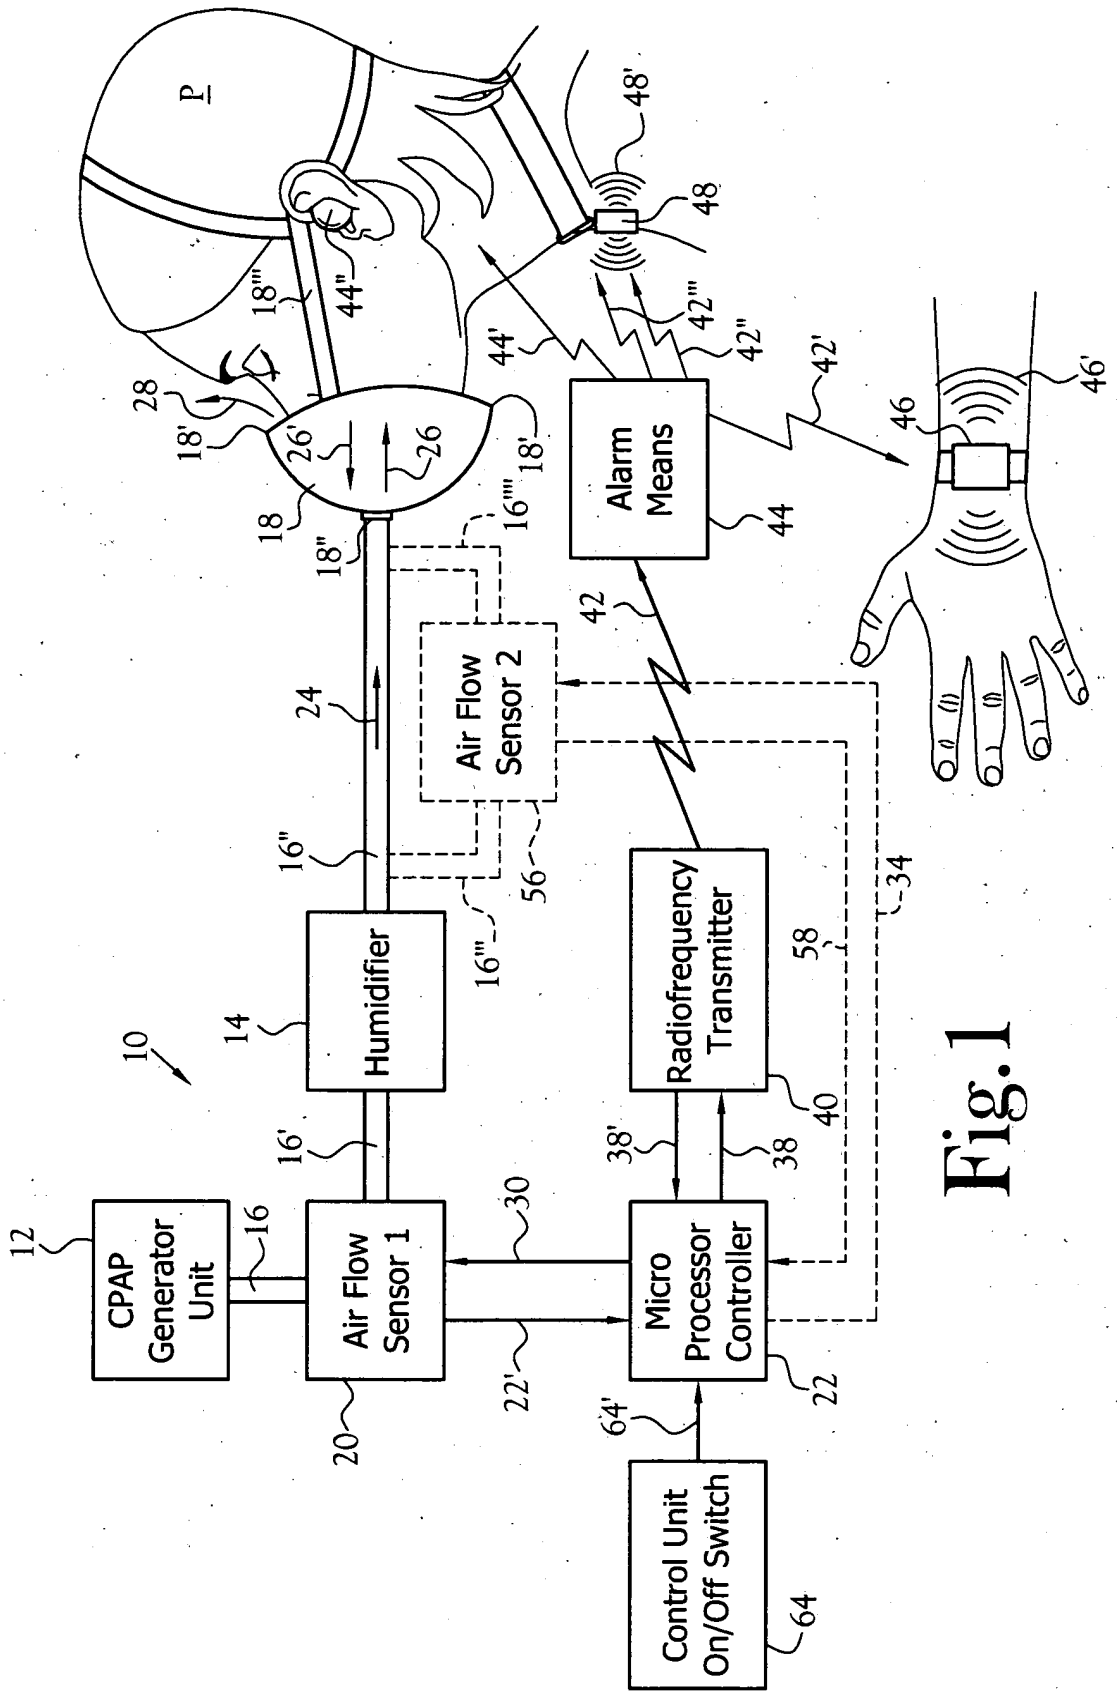
P
48'
48
18'''
44''
42'''
42''
44'
28
18'
26'
26
18'''
18
18''
16''''
18'
Alarm Means
42'
46
46'
44
42
Air Flow Sensor 2
24
16''
56
16'''
Humidifier
14
10
Radiofrequency Transmitter
58
34
16'
38'
38
40
12
CPAP Generator Unit
16
Air Flow Sensor 1
30
Micro Processor Controller
22'
22
20
64'
Control Unit On/Off Switch
64

Fig. 1

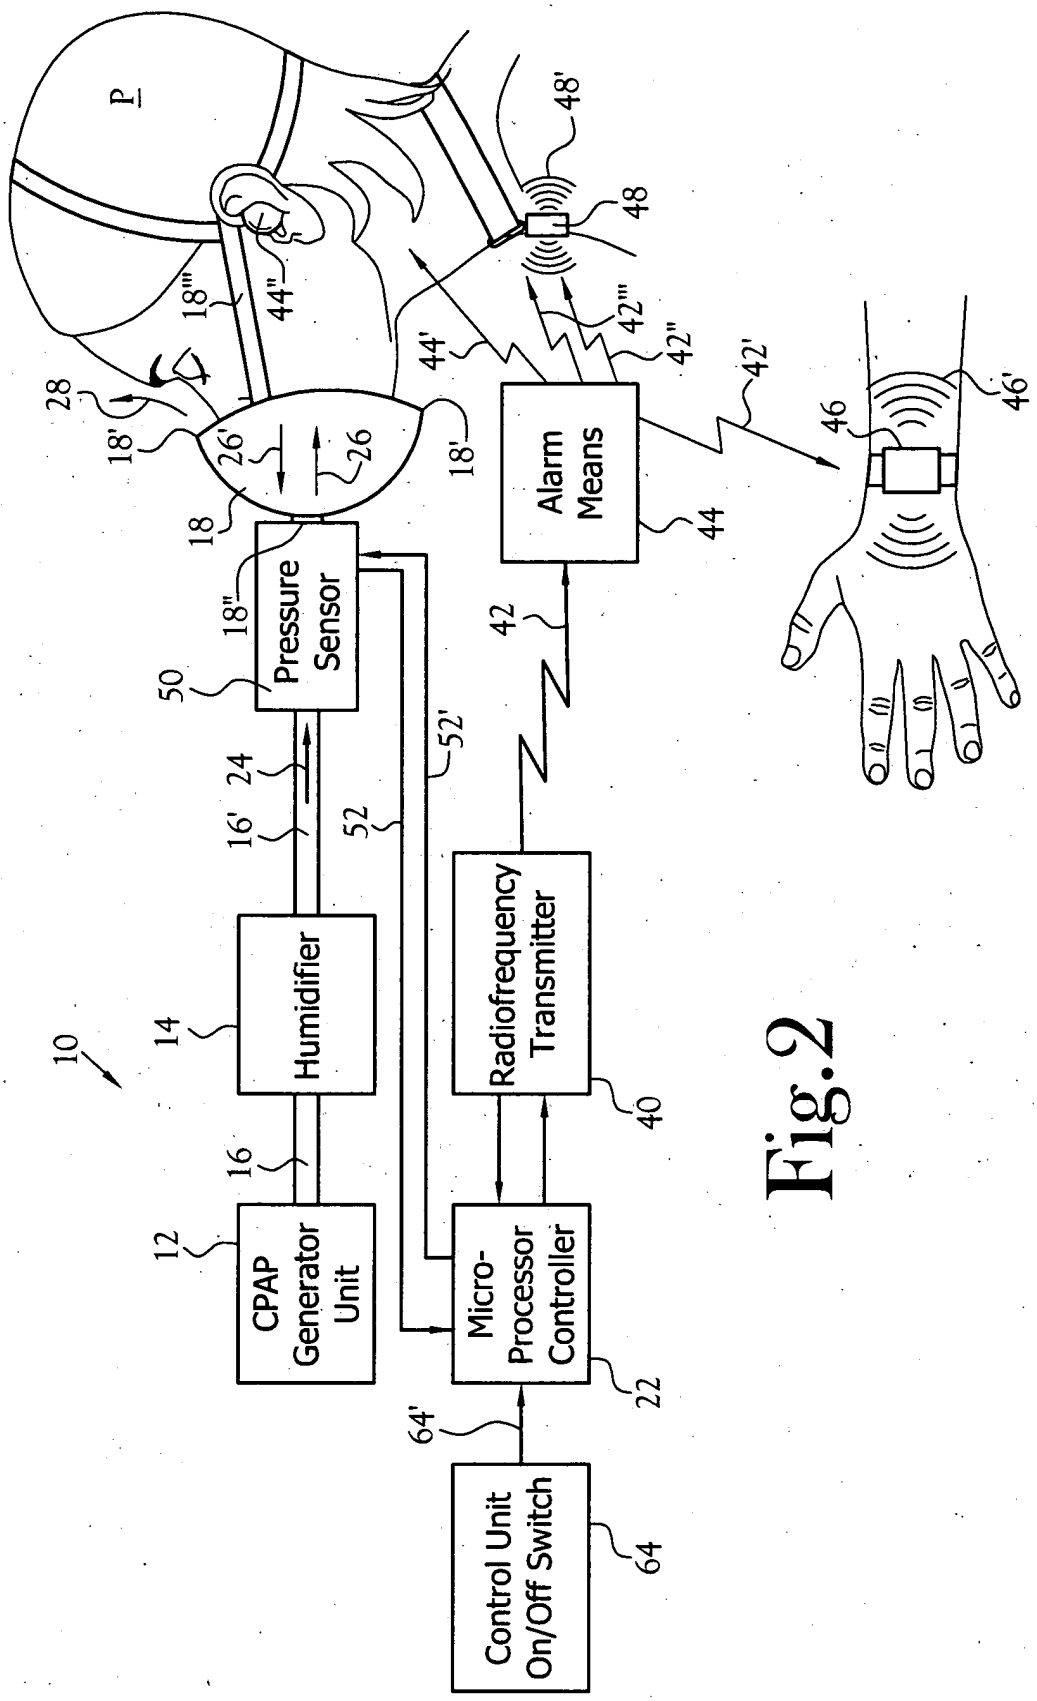
P
48'
48
18'''
44"
42'''
42"
44'
28
18'
26'
26
18'
42'
46
46'
18
Alarm Means
44
18"
Pressure Sensor
42
50
52'
24
16'
52
10
14
Humidifier
Radiofrequency Transmitter
40
16
12
CPAP Generator Unit
Micro-Processor Controller
22
64'
Control Unit On/Off Switch
64

Fig.2

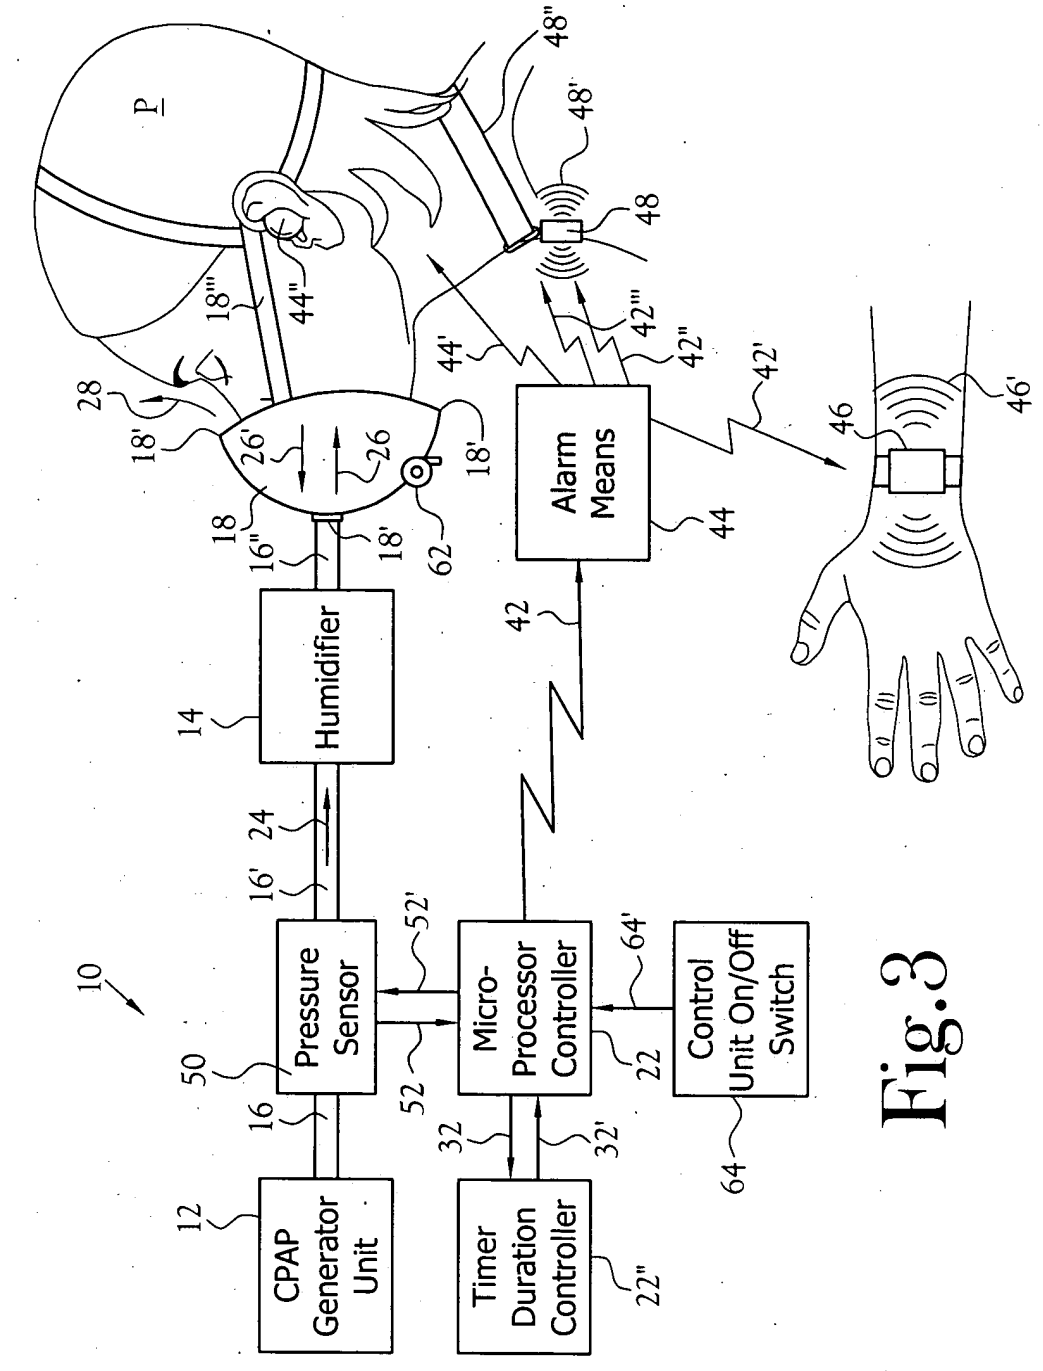
P
48"
48'
48
18'''
44"
42'''
42"
44'
42'
46
46'
28
18'
26'
26
18'
18
16"
18'
62
Alarm Means
44
Humidifier
14
42
24
16'
10
Pressure Sensor
52'
Micro-Processor Controller
64'
Control Unit On/Off Switch
50
52
22
16
32
32'
64
12
CPAP Generator Unit
Timer Duration Controller
22"

Fig.3